

## TOALLEROS

## Serie Medinox



**AI0040C**  
**Acabado brillante**



**AI0040CS**  
**Acabado satinado**

### Descripción general

- Estante para toallas con barra, para adosar a la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Consta de una repisa para almacenar toallas limpias y una barra para colgar la toalla estirada. Máxima capacidad en el mínimo espacio.
- Ideal para almacenar toallas y tenerlas siempre a mano.
- Adecuada para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- Sin componentes desmontables.
- Tiene las fijaciones a la pared ocultas para una mayor belleza del producto.
- Medios para fijar a la pared suministrados.


### Componentes y materiales

- **AI0040C:** estante para toallas con barra, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- **AI0040CS:** estante para toallas con barra, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **REPISA:** compuesta por 6 barras, fabricadas en tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de 8 mm de diámetro.
- **BARRA:** fabricada en tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de 8 mm de diámetro.
- **BRAZO SOPORTE:** 4 unidades de acero inoxidable AISI 304, de 18 mm de diámetro.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 4 unidades de acero inoxidable AISI 304 de 1,6 mm de espesor. Se adosan a la pared mediante 4 tornillos.

### Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	<i>535 x 260 x 120 mm</i>
<b>Ø tubo barras repisa</b>	<i>8 mm</i>
<b>Ø tubo barras brazos soporte</b>	<i>18 mm</i>
<b>Espesor pletina anclaje pared</b>	<i>1,6 mm</i>

### Dimensiones

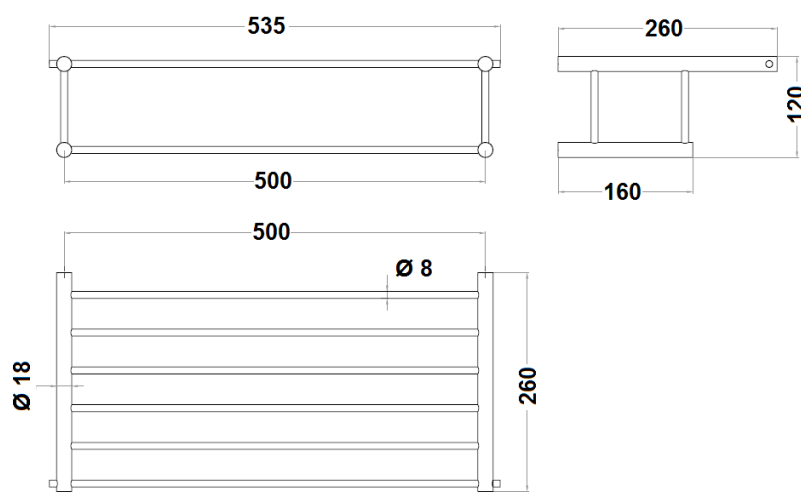


Dimensiones: ± 4%

## Montaje

## Alturas recomendadas de instalación

Fijar las 4 pletinas de anclaje a la pared, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

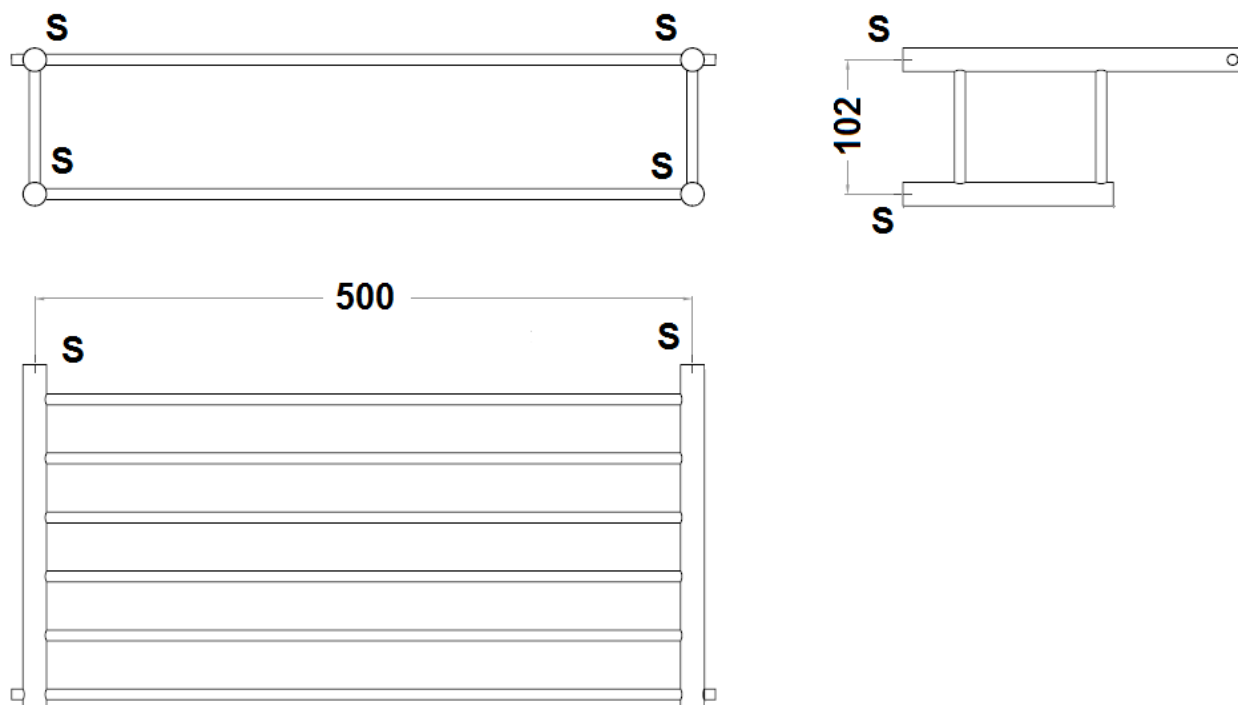

La altura recomendada de instalación es de 1.500 mm desde el suelo a la parte superior de la repisa.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
Revisión 06-18 © mediclinics S.A.

