

Winkelgriff mit Seifenschale

mediclinics

DE

Winkelgriff

Serie Medicrom

Ref. AC0957C



AC0957C

Verchromtes Messing

Glänzend

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Abgewinkelter Wandhaltegriff mit Drahtseifenablage.
- Er verfügt über eine Drahtseifenablage, die speziell für die Aufnahme eines Seifenstücks ausgelegt ist. Die Seifenablage kann in zwei Positionen montiert werden, sodass derselbe Haltegriff sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite installiert werden kann.
- Geeignet für den privaten Gebrauch und den Hotel- und Gaststättenbereich, einschließlich Hotelbädern. Auch für Gemeinschaftseinrichtungen geeignet.
- Wird mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage geliefert.


TECHNISCHE DATEN


Rohrdurchmesser des Haltegriffs	*25 mm*
Wandstärke des Haltegriffrohrs	*1 mm*
Dicke der Verchromung	*9-10 µm Nickel*
	0,3-0,4 µm Chrom

KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- **Haltegriff:** In der Mitte mit einem Winkel von 133° gebogen; beide Enden sind um 90° abgewinkelt und mit den Wandbefestigungsplatten verschweißt.
- **Befestigungsplatte:** 2 gestanzte Platten mit jeweils 3 Bohrungen mit Ø 5 mm zur Wandmontage.
- **Abdeckrosette:** 2 Stück aus glänzend verchromtem Messing.
- **Seifenablage:** Drahtausführung aus verchromtem Messing.

ABMESSUNGEN

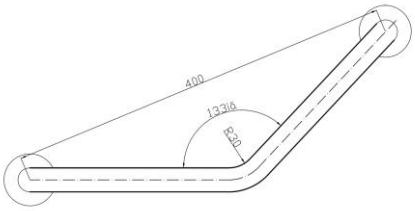

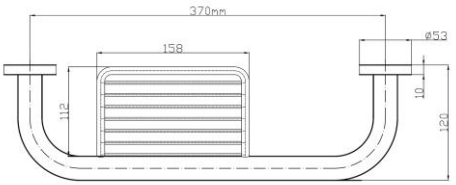

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.


Winkelgriff mit Seifenschale

LEISTUNGSTEXT

Der abgewinkelte Wandhaltegriff mit integrierter Drahtseifenablage ist aus glänzend verchromtem Messingrohr mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Wandstärke von 1 mm herzustellen. Das Rohr ist in der Mitte mit einem Winkel von 133° gebogen. Der Haltegriff ist mit zwei Befestigungsplatten mit jeweils drei Bohrungen sowie zwei glänzend verchromten Messing-Abdeckrosetten mit einem Durchmesser von 53 mm auszustatten.

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Die Montageplatte ist mithilfe der mitgelieferten Schrauben in der gewünschten Höhe an der Wand zu befestigen. Dabei sind die Abstände zwischen den in der folgenden Abbildung mit „S“ gekennzeichneten Punkten zu berücksichtigen.

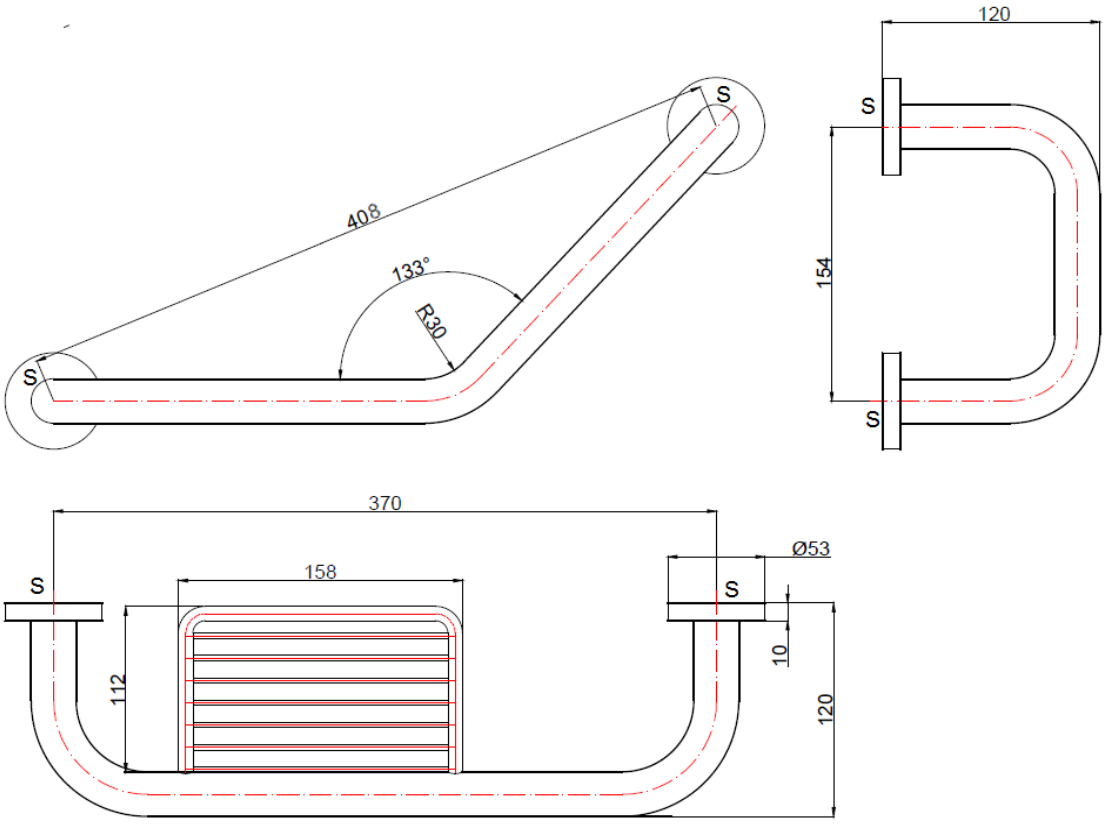

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.