

ESPEJOS



EP0350 / EP0450
Acabado blanco

Fijos con marco de acero o inoxidable AISI 304



EP0350B / EP0450B
Acabado negro mate



EP0350CS / EP0450CS
Acabado satinado

Descripción general

- Espejo rectangular fijo con marco de una sola pieza, de 1 mm de espesor, fabricado con acero acabado blanco (EP0350 o EP0450), o con acero acabado negro mate (EP0350B o EP0450B), o con acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (EP050CS o EP0450CS).
- Vidrio de 6 mm de espesor.
- Reverso con tablero de fibras de densidad media, hidrófugo de 10 mm de espesor, para reforzar el vidrio haciéndolo más resistente y alargando su durabilidad.
- Buena resistencia a la oxidación.

Componentes y materiales

- EP0350 / EP0450:** espejo rectangular fijo, con marco de acero acabado blanco, de 1mm de espesor y con cristal de 6 mm de espesor.
- EP0350B / EP0450B:** espejo rectangular fijo con marco de acero acabado negro mate, de 1mm de espesor y con cristal de 6 mm de espesor.
- EP0350CS / 0450CS:** espejo rectangular fijo, con marco de acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor y con cristal de 6 mm de espesor.
- MARCO:** de 1 mm de espesor, con esquinas soldadas y pulidas. Ángulos reforzados de 1 mm de espesor que proporcionan una rigidez adicional al espejo.
- PARTE POSTERIOR:** tablero de fibras de densidad media, hidrófugo de 10 mm de espesor, para reforzar el vidrio haciéndolo más resistente y alargando su durabilidad.
- VIDRIO:** fabricado con un cristal de 6 mm de espesor.


Especificaciones técnicas

Dimensiones	700x500x19mm (EP0350, EP0350B y EP0350CS) 800x600x19 mm (EP0450, EP0450B y EP4350CS)
-------------	---

Espesor marco	1 mm
---------------	------

Espesor vidrio	6 mm
----------------	------

Dimensiones

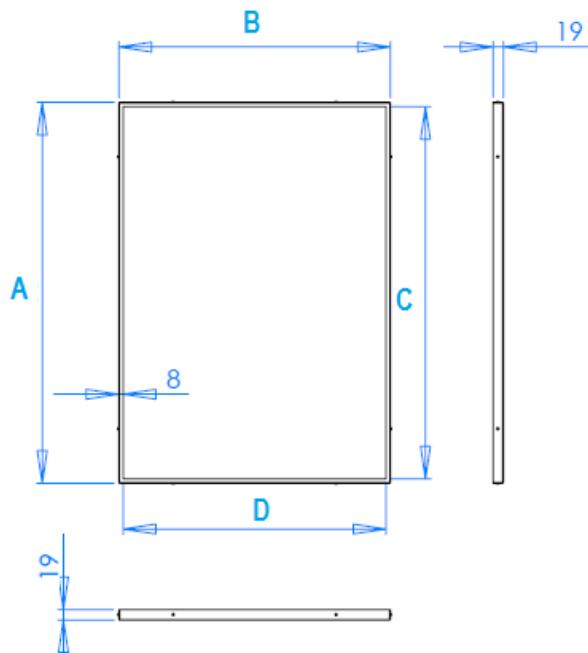


Dimensiones: ± 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar el espejo a la pared, utilizando los medios de fijación más adecuados para la pared donde va instalado, a través de los agujeros marcados con una "S" en la figura siguiente:

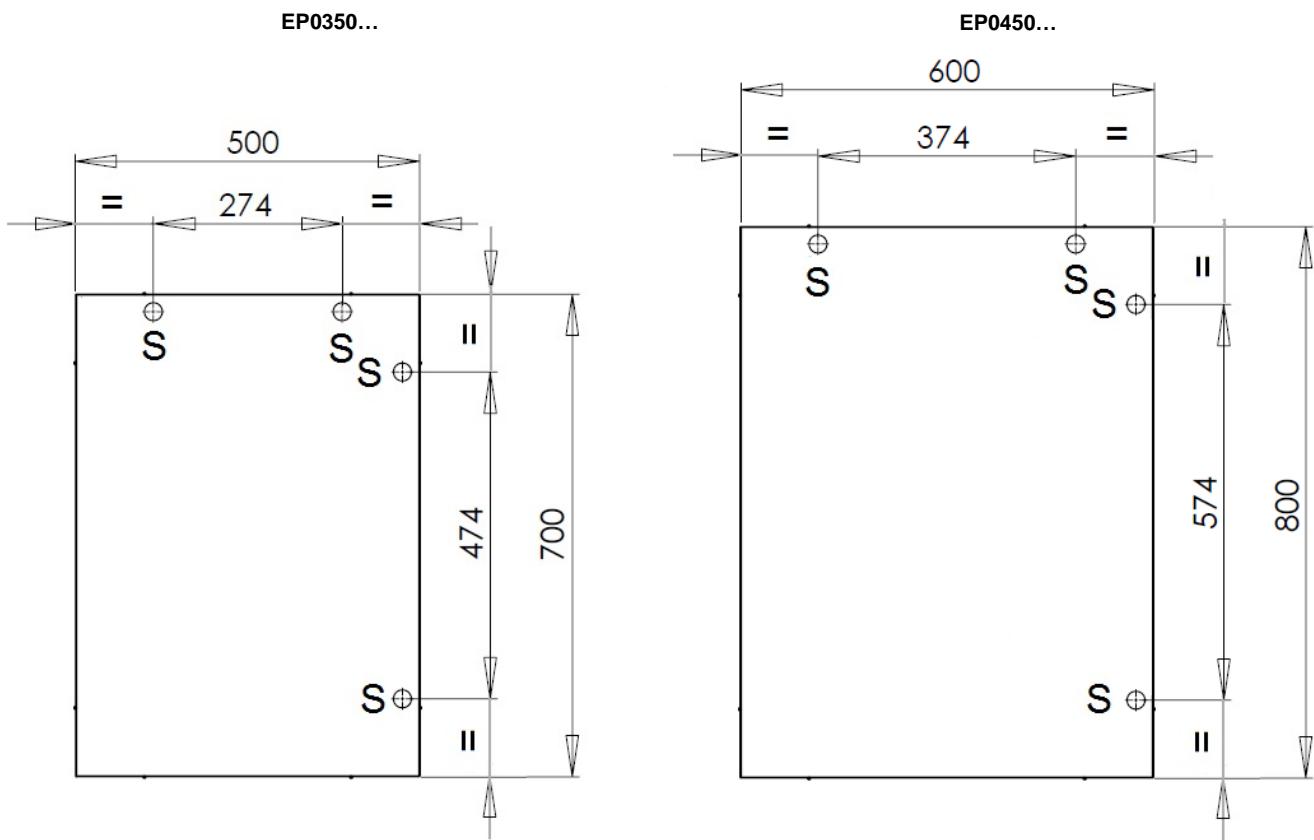

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 03-24

© mediclinics S.A.

