

## SPIEGEL

Fest montiert mit einem Rahmen aus Stahl oder Edelstahl AISI 304



**EP0350 / EP0450**  
Weiß



**EP0350B / EP0450B**  
Mattschwarz



**EP0350CS / EP0450CS**  
Satinier

### Allgemeine Beschreibung

- Rechteckiger fest montierter Spiegel mit einteiligem Rahmen, 1 mm dick, aus Stahl in Weiß (EP0350 oder EP0450), oder aus Stahl in Mattschwarz (EP0350B oder EP0450B), oder aus satiniertem Edelstahl AISI 304 (EP050CS oder EP0450CS).
- 5 mm dickes Glas.
- Rückseite mit 10 mm dicker, feuchtigkeitsbeständiger mitteldichter Faserplatte zur Verstärkung des Glases, wodurch es widerstandsfähiger und seine Haltbarkeit verlängert wird.
- Gute Oxidationsbeständigkeit.


### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	700x500x19 mm (EP0350, EP0350B und EP0350CS) 800x600x19 mm (EP0450, EP0450B und EP4350CS)
<b>Materialstärke Rahmen</b>	1 mm
<b>Materialstärke Glas</b>	5 mm

### Abmessungen

### Komponenten und Materialien

- **EP0350 / EP0450:** Rechteckiger, fest montierter Spiegel mit weißem Stahlrahmen, 1 mm dick, und 5 mm dickem Glas.
- **EP0350B / EP0450B:** Rechteckiger, fest montierter Spiegel mit mattschwarzem Stahlrahmen, 1 mm dick, und 5 mm dickem Glas.
- **EP0350CS / 0450CS:** Rechteckiger, fest montierter Spiegel mit Rahmen aus Edelstahl AISI 304, 1 mm dick, und 5 mm dickem Glas.
- **RAHMEN:** 1 mm dick, mit geschweißten und polierten Ecken. Verstärkte Ecken mit einer Stärke von 1 mm, die dem Spiegel zusätzliche Festigkeit verleihen.
- **RÜCKSEITE:** 10 mm dicke, feuchtigkeitsresistente mitteldichte Faserplatte zur Verstärkung des Glases, wodurch es widerstandsfähiger und seine Haltbarkeit verlängert wird.
- **GLAS:** Aus 5 mm dickem Glas.

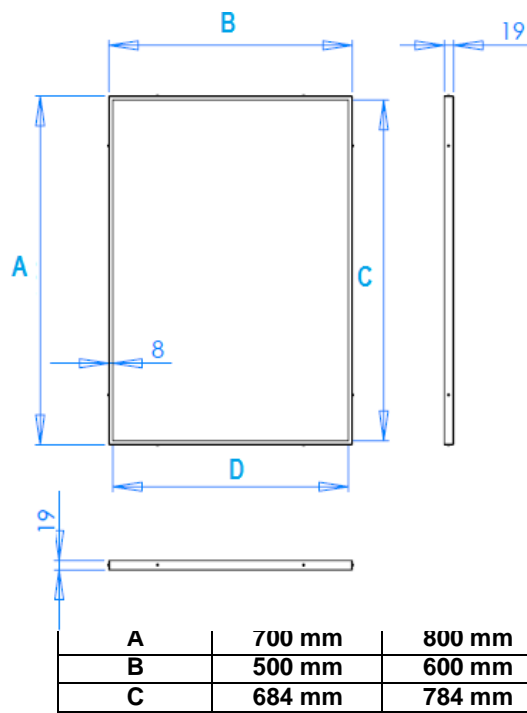


Abmessungen: ± 4 %

## Montage

## Empfohlene Installationshöhe

Den Spiegel mit den für die vorgesehene Wand am besten geeigneten Befestigungsmethoden an der Wand befestigen, und zwar durch die in der folgenden Abbildung mit einem "S" gekennzeichneten Löcher:

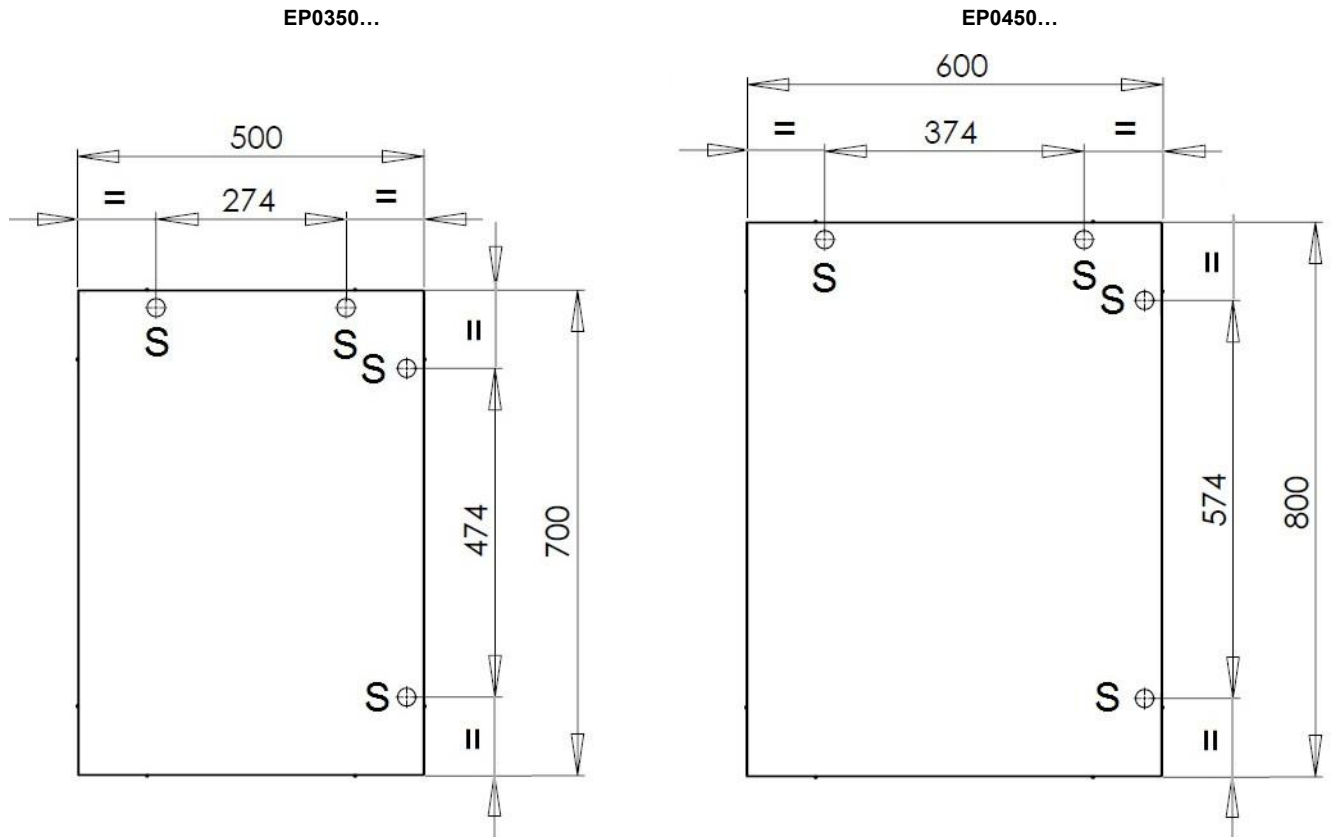

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.  
Überarbeitung 05-23

© mediclinics S.A.

