ABFALLBEHÄLTER UND -EIMER

ABFALLBEHÄLTER | Vertieft



PPE0035CS
Satiniert

Allgemeine Beschreibung

- Abfallbehälter mit selbstschließendem Deckel zum direkten Einbau in die Wand, Fassungsvermögen 4 l, vollständig aus Edelstahl AISI 304, mit satinierter Oberfläche an allen sichtbaren Teilen. Vollständig verschweißt, mit soliden Ecken, ohne Grate und scharfe Kanten.
- Geeignet für Waschräume und stark frequentierte öffentliche Innenbereiche. Modell geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen.
- Modernes, avantgardistisches und sehr robustes Design, das diesen vertieften Abfallbehälter zu einem vandalismussicheren Produkt mit langer Lebensdauer macht.
- Das Öffnen und Schließen erfolgt über ein standardmäßiges Mediclinics-Zylinderschloss mit Schlüssel.
- Entspricht den ADA-Vorschriften.


Komponenten und Materialien

- **GEHÄUSE:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, alle sichtbaren Teile sind satiniert.
- **TÜR:** aus Edelstahl AISI 304, 1,2 mm dick, satiniert, mit einem Klavierscharnier am Gehäuse befestigt. Das Öffnen und Schließen erfolgt über ein standardmäßiges Mediclinics-Zylinderschloss mit Schlüssel.
- **SELBSTSCHLIESSENDER DECKEL:** manuelle Betätigung mit automatischer Rückstellung, aus Edelstahl AISI 304,
  0,8 mm dick, satiniert. Mit Feder für automatische Rückstellung.
- **ABFALLEIMER:** aus Edelstahl, 0,8 mm dick und 4 l Fassungsvermögen.

Technische Daten

Abmessungen	*437 x 326 x 85 mm*
Wandöffnung	390 mm x 280 mm x 70 mm
Fassungsvermögen Eimer	*4 l*
Dicke der Tür und des selbstschließenden Deckels	*1,2 mm*
Materialstärke von Rahmen und Gehäuse	*0,8 mm*
Materialstärke des Abfalleimers	*0,8 mm*
Nettogewicht	*4,7 kg*

Abmessungen

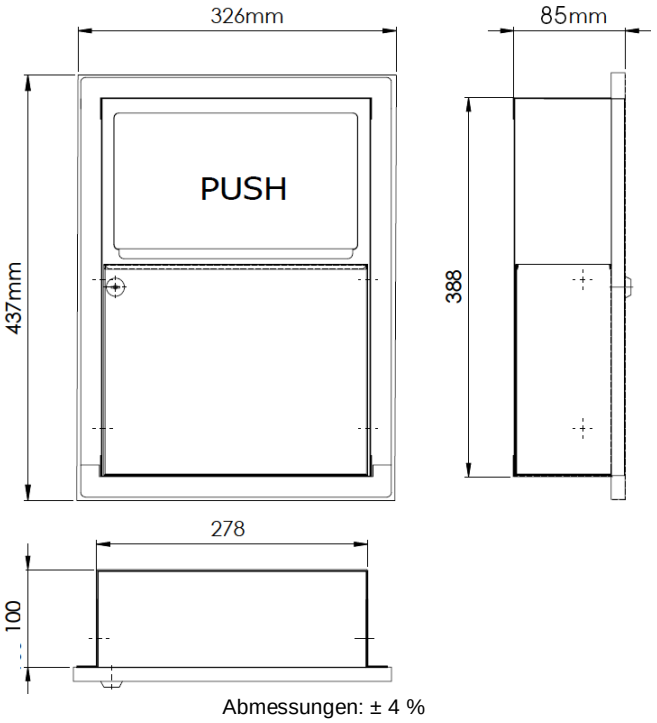


Abmessungen: ± 4 %

Bedienung

Drücken Sie den Deckel so weit auf, dass genügend Platz zum Einwerfen des Abfalls in den Eimer entsteht.

Montage

Bohren Sie ein Loch in die Wand mit den Abmessungen 390 mm (L) x 280 mm (H) x 70 mm (T). Setzen Sie die Einheit in die Aussparung ein und befestigen Sie diese mit Edelstahlschrauben durch die 4 seitlichen Löcher (2 + 2) an den Wänden der Aussparung. Beachten Sie dabei die Abstände der mit „S“ gekennzeichneten Punkte in der folgenden Abbildung:

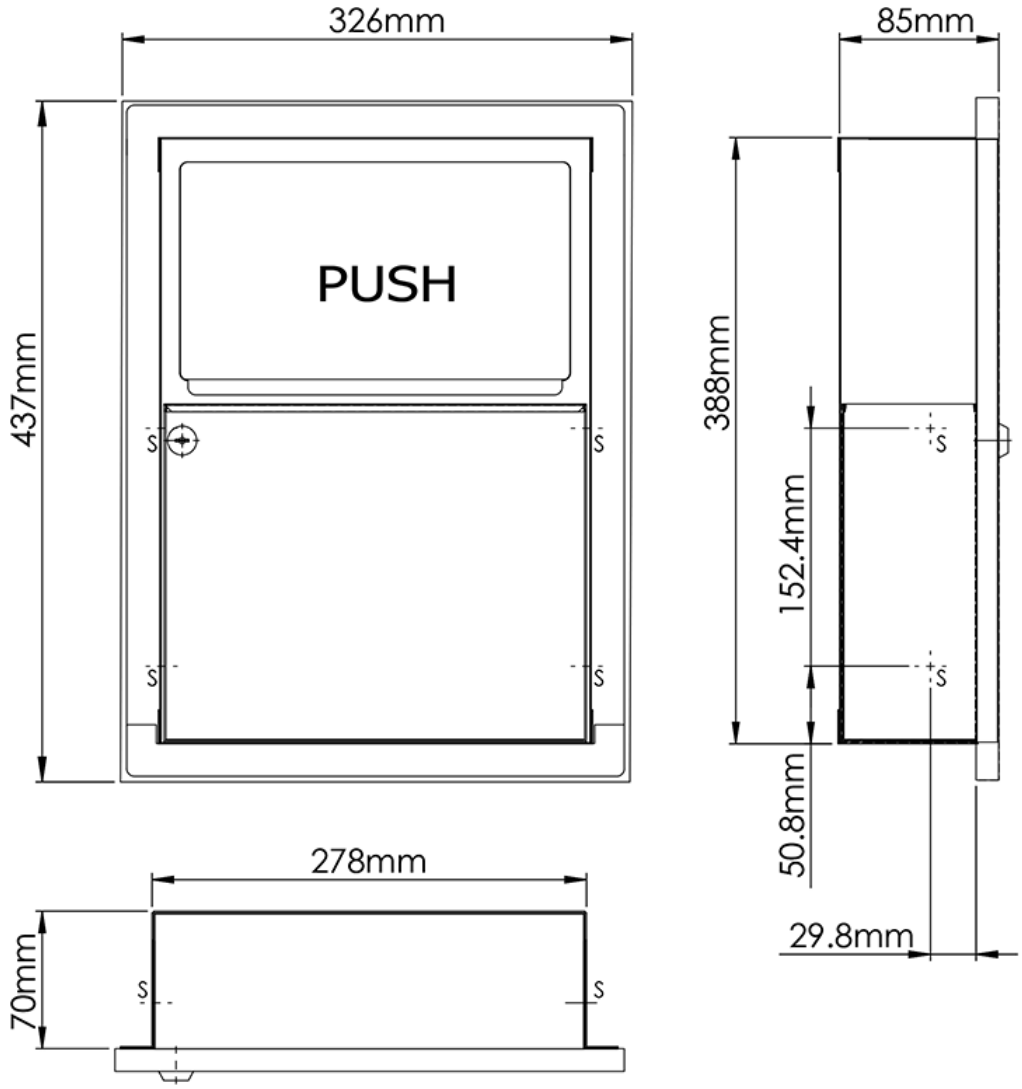

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen
Überarbeitung 11-24
© **medi**clinics S.A.